

CATALOG

Innovating Korean Dental Solutions

 06 69 40 77 14
 www.dentalgatewayintl.com
 Casablanca, Maroc



RADIO PORTABLE

DX3000



GARANTIE
5 ANS

Abonnement
dosimétrique



PIÈCES À FOURNIR

- Copie du diplôme du Docteur;
- Copie de l'attestation d'inscription du Docteur au Conseil National de l'Ordre des Médecins Dentistes;
- Formulaire D-3 de demande d'autorisation d'utilisation par l'AMSSNuR, dûment rempli, signé et cacheté par le Docteur;
- Bon de commande signé et cacheté par le Docteur;
- Demande d'abonnement à la surveillance dosimétrique au Centre National de Radioprotection;
- Formulaires F1, F2 et F4 du Centre National de Radioprotection, dûment remplis, signés et cachetés;
- Demande d'attestation d'abonnement à la surveillance dosimétrique au Centre National de Radioprotection;
- Procuration au nom de Dental Gateway International pour récupérer l'attestation d'abonnement à la surveillance dosimétrique du Docteur.

MODÈLE	: DX3000
COULEUR	: ■ ■
GÉNÉRATEUR DE RAYON X	: INVERSEUR
VOLTAGE DU TUBE	: 60 KV (FIXE)
TUBE RADIOGÈNE	: 2MA
TEMPS D'EXPOSITION	: 0,05 ~ 1,5 SEC
PUISSANCE REQUISE	: DC 14,2 ~ 16,8 V
POIDS	: 1,8 KG
DÉTECTEUR	: FILM/CAPTEUR NUMÉRIQUE
ALIMENTATION	: 2 BATTERIES RECHARGEABLES
AFFICHAGE	: GRAPHIQUE LCD



COURANT	: 1,0 A
VOLTAGE	: 16,8 VDC
TEMPÉRATURE	: 0 ~ 40°C
MAX. COURANT	: 26 A
GAMME DE VOLTAGE	: 12 ~ 16,8 MIN
CHARGE ET DÉCHARGE	: 300 FOIS
CYCLE DE RECHARGE	: 1,5 ~ 2 HEURES


CAPTEUR NUMÉRIQUE

REX² ELITE



RÉSISTANCE ET DURABILITÉ DU CÂBLE


Les câbles peuvent résister à des forces allant jusqu'à 10 kg pour des performances fiables.

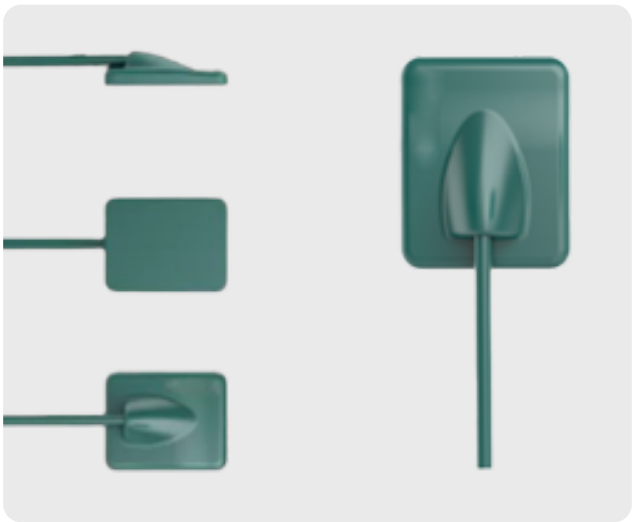

CERTIFIÉ CEI IP67 : RÉSISTANCE À L'EAU À L'ÉPREUVE

Résistant aux chocs est scellé de manière experte, garantissant sa résilience contre la submersion dans jusqu'à trois pieds d'eau pendant 30 minutes complètes.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

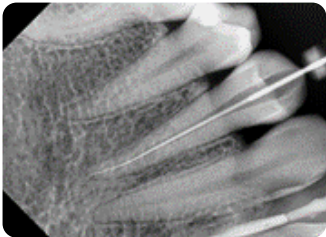

MODÈLE	: REX ² ELITE
DIMENSIONS	: TAILLE 1.5 : 25 X 30 MM
RÉSOLUTION SPATIALE	: 18,2 IP/MM (THÉORIQUE)
LONGUEUR DU CÂBLE USB	: 3 M (EXTENSIBLE)
ZONE D'IMAGERIE	: 25 X 30 MM ²
ZONE DU CAPTEUR	: 30 X 37 MM ²
ÉPAISSEUR	: 5 MM
FORMAT D'IMAGE	: BMP/DIC/DCM/JPEG/PNG/TIFF
CONNEXION	: USB
SYSTÈME	: WINDOWS 7, 8 ET 10

GARANTIE
2 ANS

PACK : RADIO PORTABLE + CAPTEUR NUMÉRIQUE

DX3000 + REX² ELITE

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE CABINET DENTAIRE



Dx3000



Rex² Elite



ÉCONOMISEZ 4 000 DH EN OPTANT POUR LE PACK !



Confort patient optimal



Faible dose de rayonnement



Images haute qualité et haute définition



Design compact et ergonomique



Qualité Dexcowin | Technologie fiable | Service après-vente assuré

DIFFUSEUR À 4 FIBRES OPTIQUES

4-FD



REEMPLACER LE FLASH DE VOTRE APPAREIL PAR 4 FIBRES OPTIQUES POUR UNE PHOTOGRAPHIE DENTAIRE SIMPLE ET ABORDABLE.

**SYSTÈME LUMINEUX
LÉGER ET ÉCONOMIQUE**
PRATIQUE POUR APPAREILS
PHOTO DENTAIRES.

COMPATIBILITÉ
AVEC LES APPAREILS
CANON ET NIKON.



**SANS BATTERIE NI
RECHARGE**
ALIMENTÉ DIRECTEMENT
PAR L'APPAREIL PHOTO

DEUX TYPES DE FIXATION
À BAGUE DE GUIDAGE OU
À CLIP



CONTENU DE L'EMBALLAGE




VENTILATEUR FF-PHOTO


DMBF-220



MIROIR INTRA-ORAL ANTI-BUÉE POUR LA PHOTOGRAPHIE DENTAIRE.

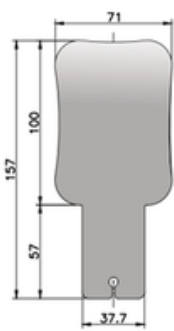

DMBFM

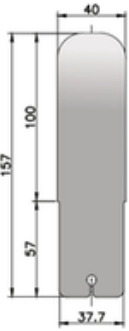


DMBFLT



DMBF-220

CONTENU DE L'EMBALLAGE

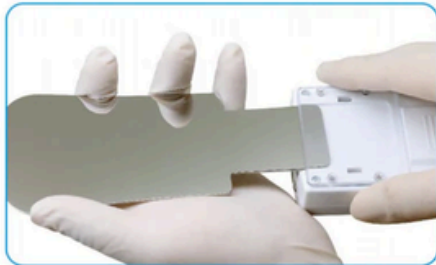

LAMPE FRONTALE SHADOWLESS DR. KIM

DKH-50



LA LAMPE FRONTALE N°1 AU MONDE

- SANS FIL, LÉGER, ROBUSE
- DEUX SOURCES LUMINEUSES BREVETÉES
- L'INTENSITÉ LUMINEUSE EST JUSQU'À 100.000 LUX
- LUMINOSITÉ FACILEMENT RÉGLABLE
- INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUE
- LOUPES EN OPTION ET JUMELLES PERSONNALISABLES
- CAMÉRA NUMÉRIQUE HD EN OPTION

LOUPES 1.5

DKL-5



ZOOM : 1.5
POIDS : 13G
DISTANCE TRAVAIL :
5-100CM
TAILLE DU CHAMP DE
TRAVAIL JUSQU'À 45CM

LOUPES 2.5

DKT-3



ZOOM : 2.5
POIDS : 19G
DISTANCE TRAVAIL :
20-100CM (MULTIFOCUS)
TAILLE DU CHAMP DE
TRAVAIL JUSQU'À 15CM

SET COMPLET : LOUPES 1.5

S-DKH-50




- BOITE
- LAMPE DKH-50
- CHARGEUR
- LOUPES DKL-5 : **1.5**
- 2 BATTERIES RECHARGEABLES
- 3 PAIRES DE FILTRE

SET COMPLET : LOUPES 2.5

S-DKT-3



- BOITE
- LAMPE DKH-50
- CHARGEUR
- LOUPES DKT-5 : **2.5**
- 2 BATTERIES RECHARGEABLES
- 3 PAIRES DE FILTRE

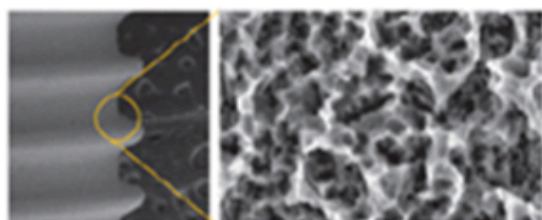

Surface S.L.A


(Sandblasted with Large Grit and Acid Etched)

Surface S.L.A permet un bon contact implant-os avec de bonnes performances cliniques, en maintenant la marge osseuse crestale.

Réf.: Kim H., et Al. "The Biocompatibility of SLA-Treated Titanium Implants" Biomed. Mater. 2008;3(2):025011

Connexion Conique Interne


- La connexion conique interne entre l'implant et l'interface du pilier permet une étanchéité parfaite.
- Une seule connexion de pilier est utilisée pour tous les diamètres de l'implant.
- Une seule vis s'adapte à tous les piliers et plates-formes de l'implant.
- Un tournevis hexagonal convient à toutes les vis de pilier.

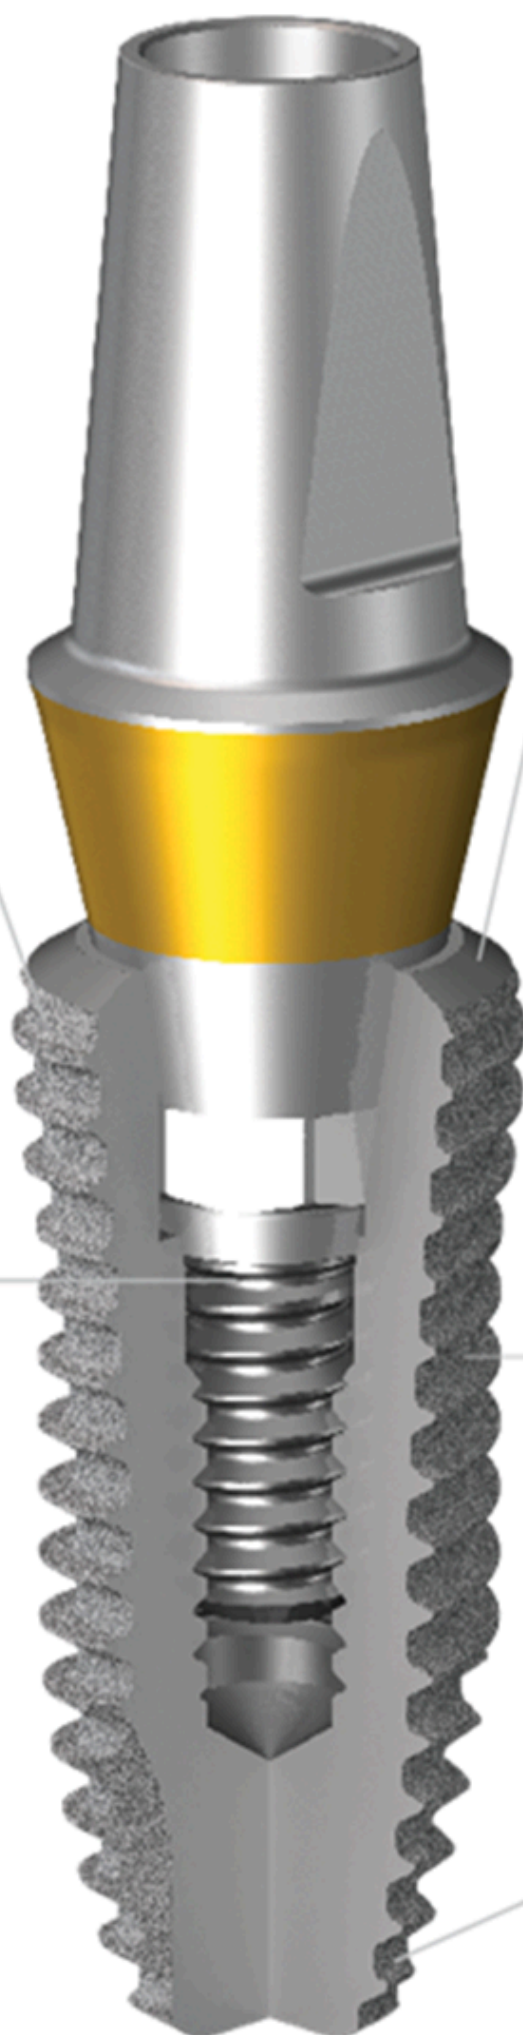

Concept "Platform Switching

La "Platform Switching est bénéfique pour la préservation de l'os marginal.

Réf.: Hsu. et. al. "Comparison of Clinical and Radiographic Outcomes of Platform-Switched Implants with a rough Collar and Platform Matched Implants with a Smooth Collar: A 1-Year Randomized Clinical Trial Int J Oral Maxillofac Implants 2016;30:382-290

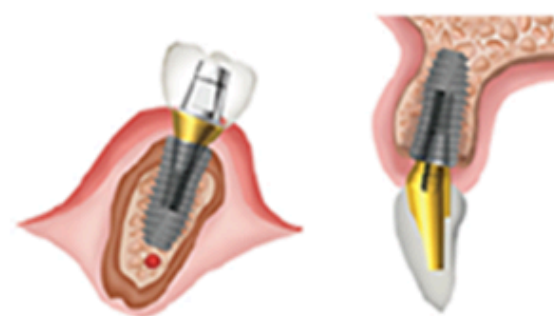

Corps Conique à Double Filetage

Le concept peut fournir un bon taux de réussite dans les cas de mise en charge immédiate.

Réf.: Kim et. Al., "A Prospective, 1-year observational study of double-threaded tapered body dental implants with immediate loading" J Prosthet Dent 2015;114:46-51

En Pointe Plate

- La conception autotaraudante à 3 lames pour minimiser la destruction osseuse.
- La forme plate réduit le risque de perforation osseuse.




SYSTÈME D'IMPLANT DENTAIRE

SuperLine

Ø3.6 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø6.0 Ø7.0



IMPLANT SUPERLINE
LONGEURS : 7 - 8 - 10 -12 - 14

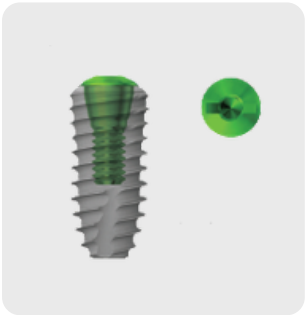

VIS DE
COUVETURE



VIS DE
CICATRISATION



SCAN
ABUTMENT



TRANSFERT



ANALOGUE



TI-TEMPORARY
ABUTMENT



CUSTOM
ABUTMENT




METAL-CASTING
ABUTMENT




DUAL
ABUTMENT



ANGLED
ABUTMENT

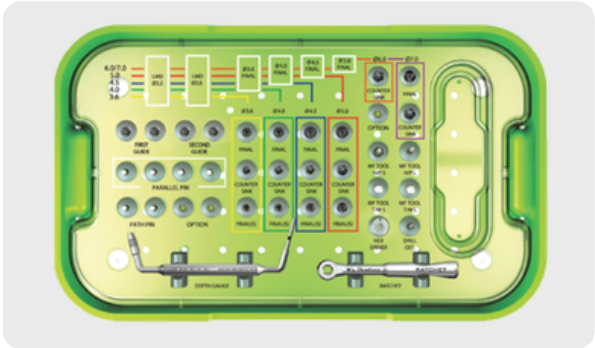


SURGICAL KIT
[FULL]

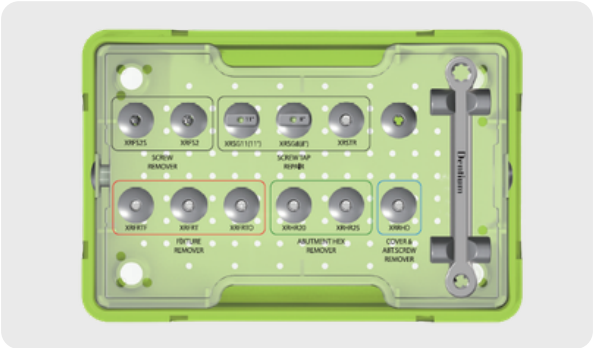

HELP KIT




ADVANCED
SINUS KIT

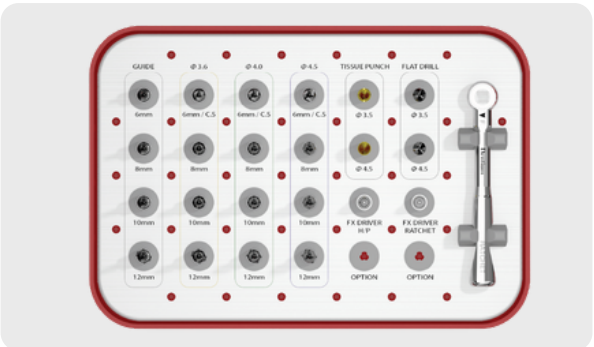

DIGITAL GUIDE
FULL KIT

SYSTÈME D'IMPLANT DENTAIRE

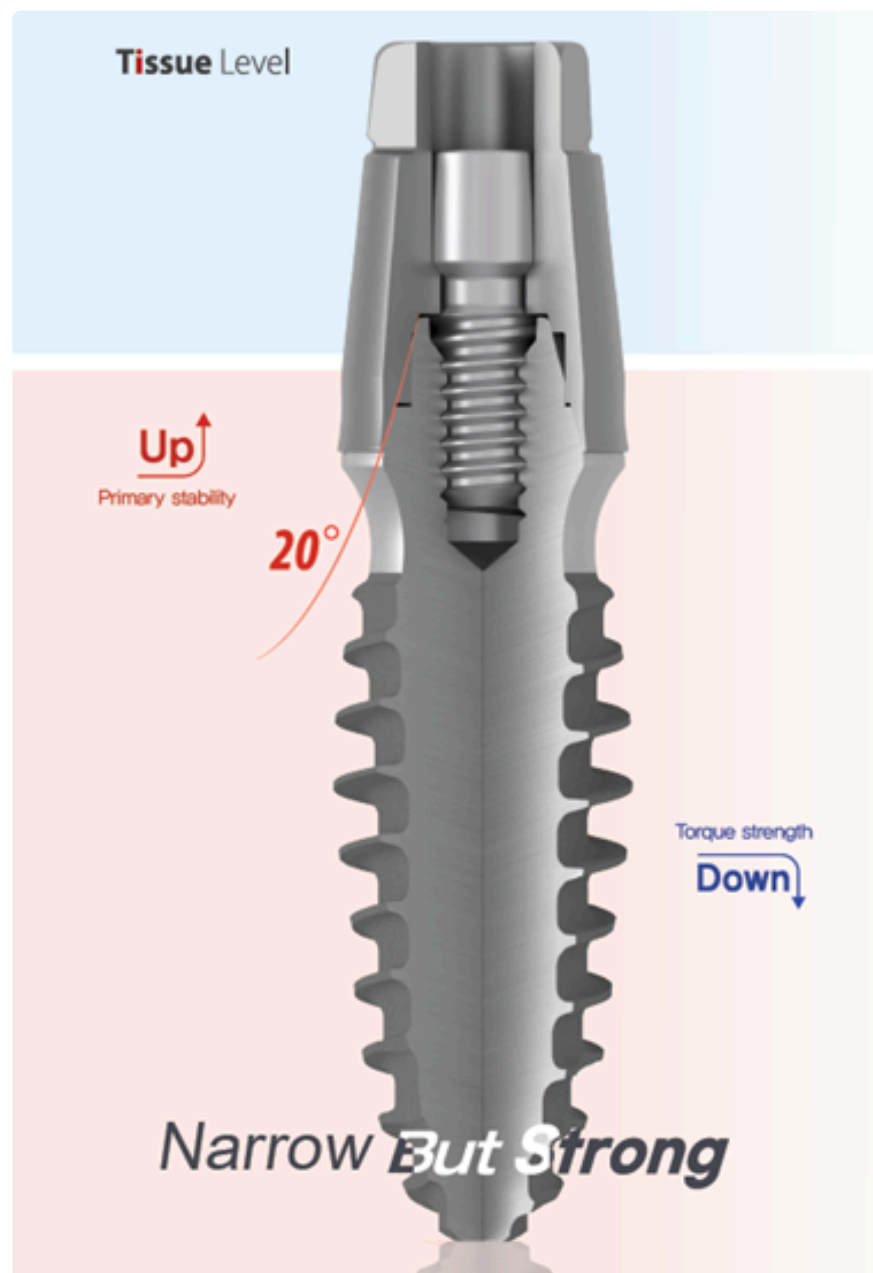

NARROW BUT STRONG (ÉTROIT MAIS FORT)

- RESTAURATION IMPLANTAIRE EN DEUX PARTIES Ø2.0MM PEUT ÊTRE RÉALISÉ SUR LES DENTS ANTÉRIEURES.
- UN IMPLANT DE Ø3,5MM PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR UNE RESTAURATION IMPLANTAIRE POSTÉRIEURE.

PLATEFORME UNIQUE Ø3.8

- CHAQUE TAILLE D'IMPLANT CORRESPOND À LA MÊME TAILLE DE PLATE-FORME.
- FLUX DE TRAVAIL PROTHÉTIQUE SIMPLIFIÉ.

CONNEXION CONIQUE EXTERNE 20 °


- EXCELLENTE STABILITÉ DES ARTICULATIONS.
- MANIPULATION FACILE POUR RESTAURATIONS MULTIPLES.

DIMENSION RÉDUITE DU COL

- MINCE ET SOUS-CONTOURNÉ.
- PROTECTION MAXIMALE DE L'OS MARGINAL.

SPIRE FIN ET PROFOND

- L'IMPLANT EN SPIRALE POINTU AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DU TROQUE ET LA STABILITÉ INITIALE.
- ZONE DE CONTACT ACCRUE ENTRE L'IMPLANT ET L'OS ALVÉOLAIRE, OPTIMISÉE POUR UNE MISE EN CHARGE IMMÉDIATE OU PRÉCOCE.

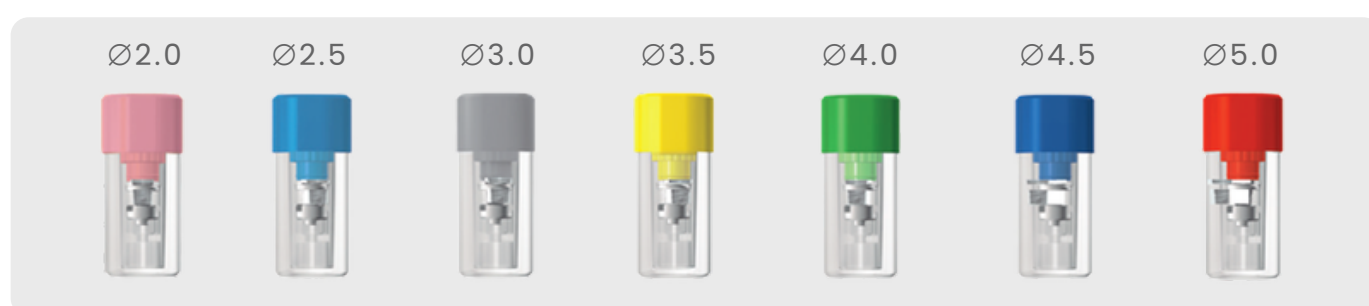

IMPLANT BRIGHT


TISSUE LEVEL
LONGEURS : 7 - 9 - 11 - 13



SCAN COMFORT CAP



ANALOGUE

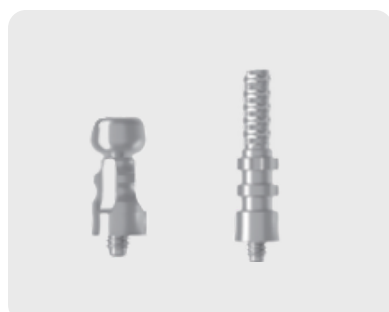


TRANSFERT / PICK-UP




PILIER TI-BASE

SYSTÈME D'IMPLANT DENTAIRE

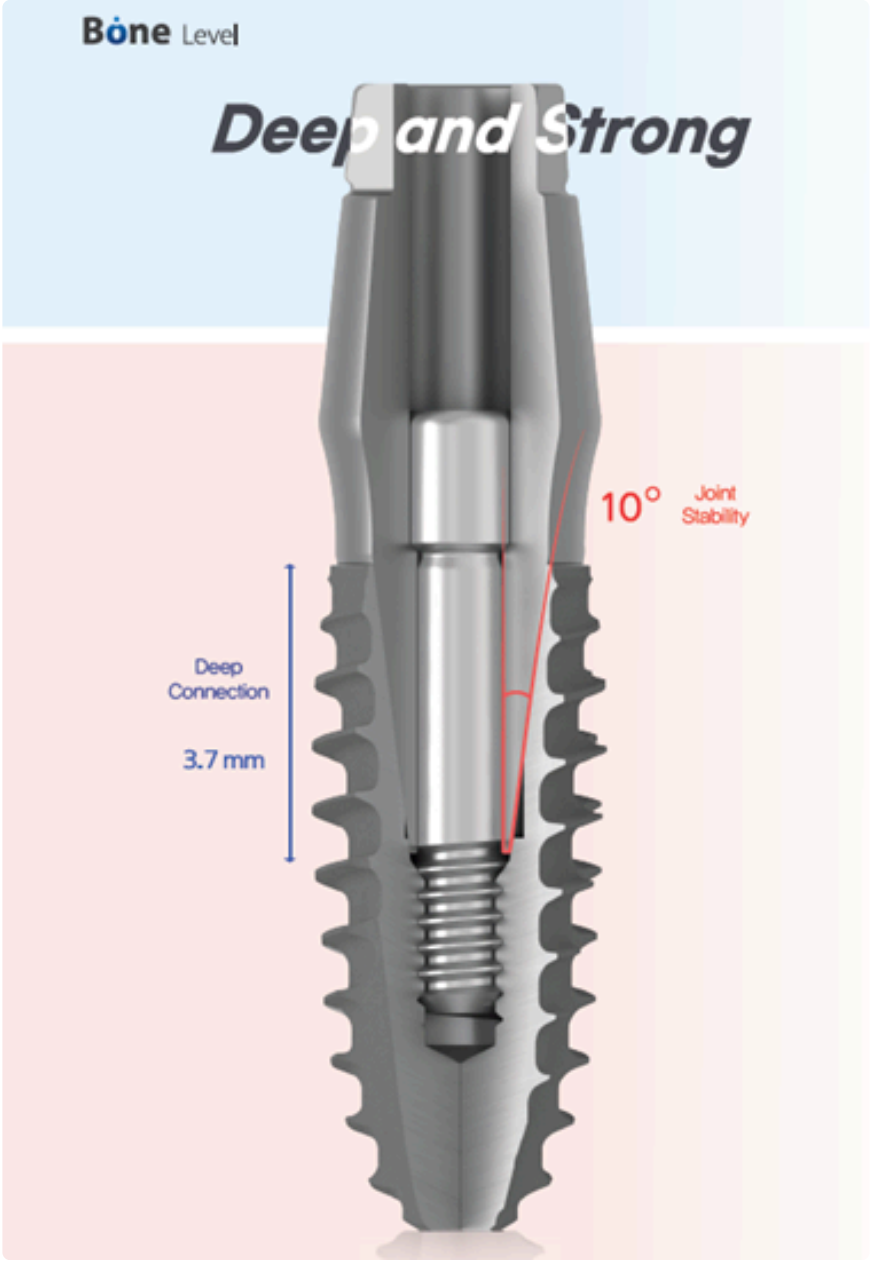


SURFACE DE CONTACT IMPLANT-PILIER (MM²)

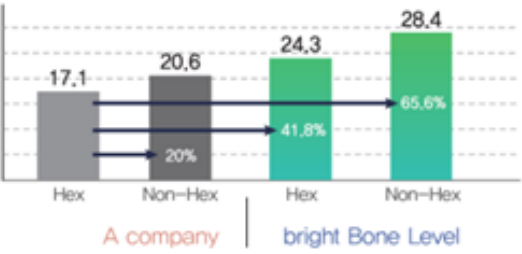

CONNEXION CONIQUE INTERNE 10°: CÔNE MORSE CONNEXION DE 3.7 MM DE PROFONDEUR


UNE PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT ENTRE L'IMPLANT ET LE PILIER MINIMISE L'AFFAISSEMENT QUI PEUT EMPÊCHER LE DESCELLEMENT.

MOINS D'AFFAISSEMENT

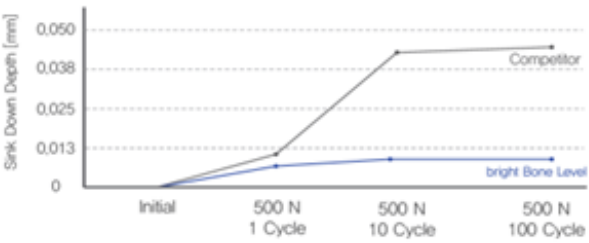

LONG TRANCHANT ET FILETAGE AGRESSIF

- LA CONCEPTION AGRESSIVE DU FILETAGE CONTRIBUE À AUGMENTER LA STABILITÉ INITIALE
- UNE INSERTION FACILE ET RAPIDE EST POSSIBLE

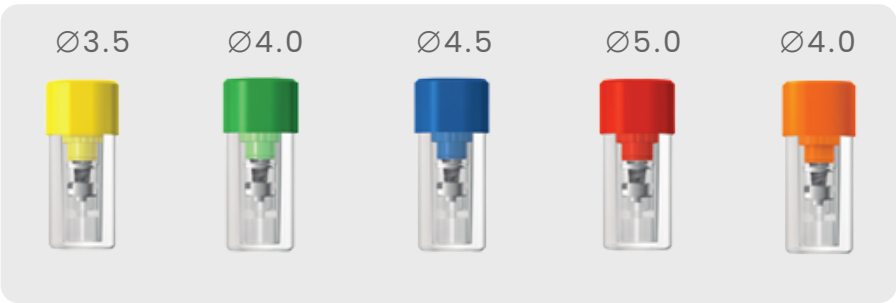

IMPLANT BRIGHT BONE LEVEL



VIS DE CICATRISATION



TRANSFERT / PICK-UP




ANALOGUE



PILIER CÉMENTÉ



PILIER TI-BASE

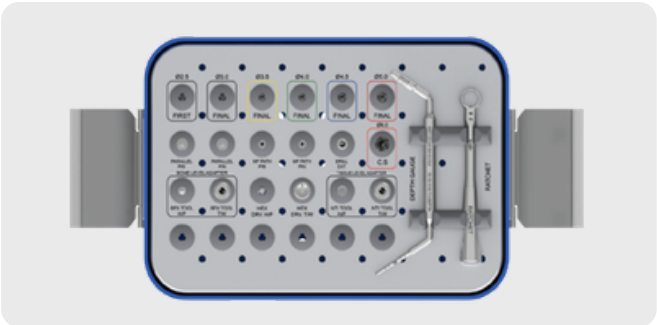


SURGICAL KIT [BRIGHT] BONE LEVEL / TISSUE LEVEL

COMPOSANTS MULTIUNIT

D Ø4.8

R

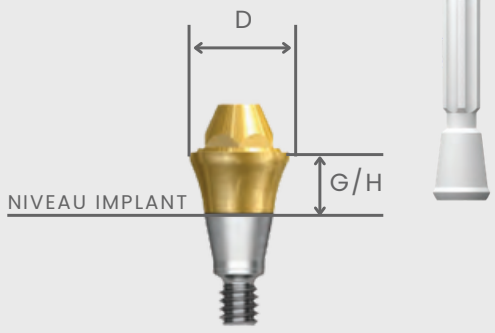


G/H :

1.0	2.0	3.0	4.0
			
TSMA5010	TSMA5020	TSMA5030	TSMA5040

TS MULTI ABUTMENT
PILIER MULTIUNIT DROIT

D Ø4.8

R

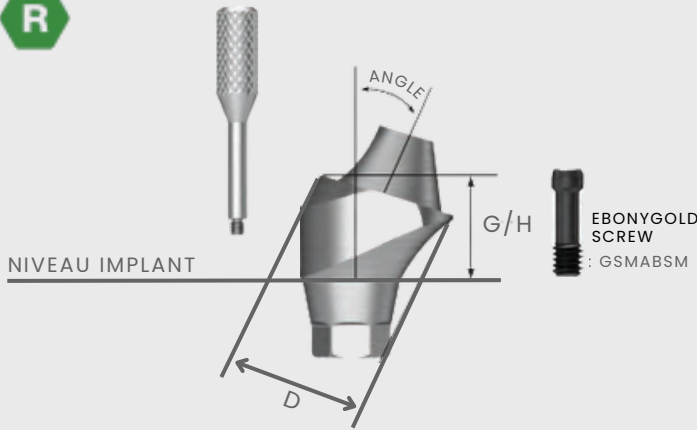

G/H :

2.5	3.0	4.0	
			
GS17MAM4820	GS17MAM4830	GS17MAM4840	
3.0			5.0
			
GS30MAM4830			GS30MAM4850

MULTI ABUTMENT
ANGLED
PILIER MULTIUNIT ANGULÉ



R Regular

TS MULTI SCAN
BODY



R Regular

ESTHETIC-LOW
LAB ANALOG



R Regular

ESTHETIC-LOW
PICK-UP
IMPRESSION
COPING



R Regular

TS MULTI
TI-BASE



R Regular

ESTHETIC-LOW
TEMPORARY
CYLINDER



R Regular

MULTI
ABUTMENT NP-
CAST CYLINDER



R Regular

ESTHETIC-LOW
HEALING CAP



MULTI
ABUTMENT
OUTER DRIVER






HAND DRIVER
TOURNEVIS

VENUS GAUGE



GAU-01



OUTIL CHIRURGICAL ESSENTIEL POUR MESURER AVEC PRÉCISION ET COHÉRENCE LA DIMENSION VERTICALE D'OCCLUSION DES PATIENTS ÉDENTÉS.

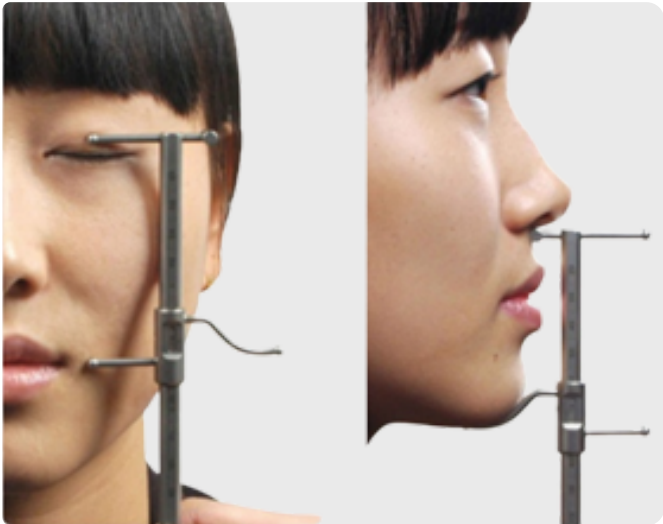


- ADAPTÉ AUX MESURES :
- DES IMPLANTS DENTAIRES À CHARGE IMMÉDIATE,
 - DES PROTHÈSES SUR IMPLANTS,
 - DE LA RECONSTRUCTION DE LA BOUCHE COMPLÈTE,
 - DES PROTECTIONS CONTRE LE RONFLEMENT.

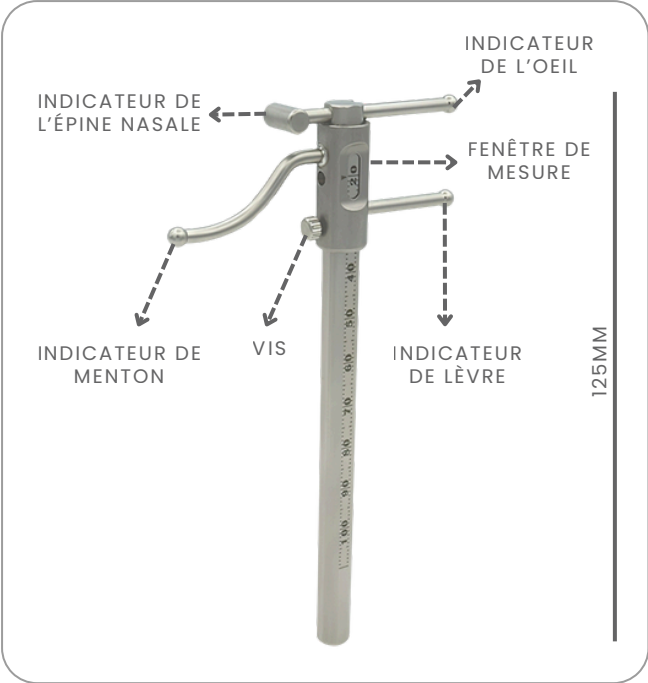

COMPREND DES POINTES ARRONDIES CONFORTABLES QUI AIDENT À ÉVITER L'ANXIÉTÉ DU PATIENT.

EXTRACTEUR D'IMPLANT

FIXTURE REMOVER

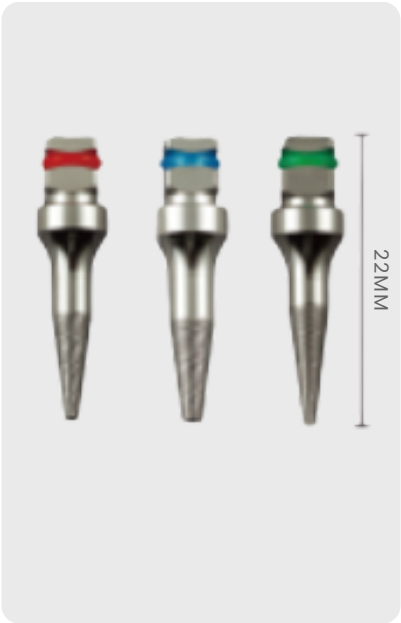

INSTRUMENT DE DÉPOSE IMPLANTAIRE PRÉSERVANT L'OS ENVIRONNANT.

FRD-01	:	Ø 1.6 - 1.8
FRD-02	:	Ø 2.0 - 2.5
FRD-03	:	NARROW

TRÉPAN

TREPHIN BUR



FRAISE UTILISÉE POUR L'EXTRACTION DE L'OS DE LA DENT OU L'IMPLANT

TPB-03	:	Ø 3.0
TPB-04	:	Ø 4.0
TPB-05	:	Ø 5.0

ENTONNOIR

FUNNEL-SET



ENTONNOIR CHIRURGICAL POUR CANALISER LE MATÉRIAU OSSEUX DANS LES ZONES DE GREFFE.

- LE FUNNEL-L SE FIXE SUR LE FUNNEL HANDLE
- IL EST ORIENTÉ SELON L'ANGLE SOUHAITÉ
- LE BIOMATÉRIAU OSSEUX EST INTRODUIT DANS L'ENTONNOIR

FRAISE PROFILEUSE

BONE PROFILER



UTILISÉ POUR ÉLIMINER L'EXCÈS D'OS AUTOUR DE L'IMPLANT.

CBP45M	:	Ø 4.5
CBP55M	:	Ø 5.5
CBP65M	:	Ø 6.5

MOTEUR D'IMPLANT

KI-20 (SINGLE)



CONTENU :

- UNITÉ DE CONTRÔLE
- 1 MICRO-MOTEUR
- 1 CONTRE ANGLE 20:1
- PÉDALE
- SUPPORT SÉRUM
- SUPPORT CONTRE ANGLE



- ADAPTÉ À LA CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE
- TORQUE MAXIMAL EST DE 70 N.CM
- 9 PROGRAMMES DE MÉMOIRE – OPTIQUE
- ECRAN LCD INCLINÉ PERMET AUX PRATICIENS DE MANIPULER FACILEMENT LES PARAMÈTRES DU MOTEUR
- NIVEAUX DE VITESSE ET TORQUE

Contre angle	1 : 1	1 : 2	20 : 1	32 : 1
RPM	600 - 40,000	1,200 - 80,000	20 - 2,000	20 - 1,200
NCM	-	-	5 - 70	5 - 90

MOTEUR D'IMPLANT

KI-20 (DUAL)



CONTENU :

- UNITÉ DE CONTRÔLE
- 1 MICRO-MOTEUR
- 1 CONTRE ANGLE 20:1
- PÉDALE
- SUPPORT SÉRUM
- SUPPORT CONTRE ANGLE



MICRO MOTEUR OPTIQUE

KI-MTO



- LÉGER À FAIBLE BRUIT ET FAIBLE VIBRATION
- TORQUE STABLE CAPABLE DE GÉRER UNE VARIÉTÉ DE PROCÉDURES D'IMPLANTATION

PÉDALE

KI-F20



- 4 NIVEAUX D'IRRIGATION
- 9 PROGRAMMES
- ROTATION : ARRIÈRE / AVANT

KRAFIT KI-AG20L




20 : 1

- CONTRE ANGLE D'IMPLANTOLOGIE DENTAIRE
- AUTOCLAVABLE À 135°C
- LAVABLE DANS LE THERMODÉSINFECTEUR

TORQUE : 70 NCM

1
AN

GBR

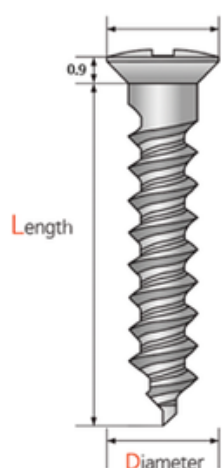


AU-16-006 6mm



FORET



- **IHA-04 :**
ADAPTATEUR
CONTRE ANGLE
- **IHA-06**
ADAPTATEUR
MANCHE

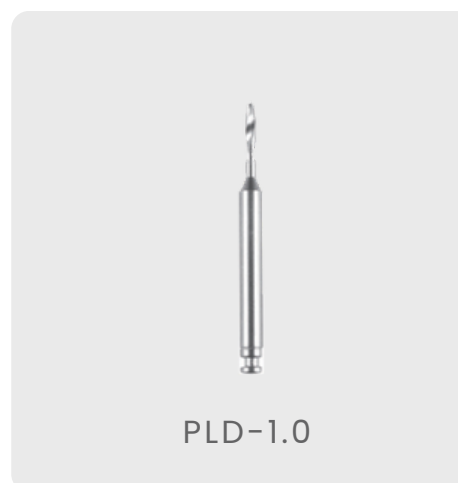

- **PLD-1.0** : FORET DE DIAMÈTRE 1.0

KIT COMPLET



- 54 MINI VIS
- 1 ADAPTATEUR CONTRE ANGLE
- 1 ADAPTATEUR MANCHE
- 1 FORET
- 1 MANCHE



18

SDH-

IHA-04

IHA-06

PLD-1.0

MEMBRANE COLLAGÈNE BOVINE

COLLA-D

LE COLLA-D EST DU COLLAGÈNE DE TYPE BOVIN PURIFIÉ.



PROPRIÉTÉ ADHÉSIVE ET FLEXIBILITÉ :

- MANIPULATION ET PLACEMENT FACILES
- HAUTE PROPRIÉTÉ HYDROPHILE ET EXCELLENTE FLEXIBILITÉ

STRUCTURE À PLUSIEURS COUCHES :

- RÉGÉNÉRATION OSSEUSE ET TISSULAIRE EFFICACE EN ASSURANT UN MAINTIEN SUFFISANT DE L'ESPACE
- FACILITER LA PROLIFÉRATION DES OSTÉOBLASTES

PÉRIODE DE RÉSORPTION : 3 À 6 MOIS

INDICATIONS :

- ✓ ÉLÉVATION SINUSIENNE
- ✓ AUGMENTATION OSSEUSE HORIZONTALE
- ✓ RECONSTRUCTION DE LA CRÊTE ALVÉOLAIRE
- ✓ DÉFAUTS DE FENESTRATION ET DE DÉHISCENCE
- ✓ AUGMENTATION DE CRÊTE OSSEUSE

GENOSS

MEMBRANE COLLAGÈNE BOVINE

COLLAGEN MEMBRANE 2 SOFT

MEMBRANE RÉSORBABLE COMPOSÉE DE COLLAGÈNE DE TYPE I HAUTEMENT PURIFIÉ D'ORIGINE BOVINE



CARACTÉRISTIQUES :

- MEMBRANE MULTICOUCHE ULTRA-FINE (300 MICROMÈTRES) FAVORISANT LA PROLIFÉRATION DES OSTÉOBLASTES
- UTILISABLE DES DEUX CÔTÉS
- MAINTIEN D'UNE STABILITÉ OPTIMALE JUSQU'À 4 MOIS AVANT RÉSORPTION
- SOUPLE ET RÉSISTANTE POUR UNE FIXATION FACILE DES PINS

PÉRIODE DE RÉSORPTION : 4 À 6 MOIS

INDICATIONS :

- ✓ DÉFAUTS PARODONTAUX/INFRA-OSSEUX
- ✓ AUGMENTATION DE LA CRÊTE OSSEUSE
- ✓ SITES D'EXTRACTION
- ✓ ÉLÉVATION SINUSIENNE
- ✓ RÉGÉNÉRATION DE LA MUQUEUSE KÉRATINISÉE

OS SYNTHÉTIQUE

INROAD


90% **CALCIUM HYDROXYAPATITE (HA)** + 10% **BETA TRI CALCIUM PHOSPHATE (B-TCP)**



GRÂCE À SA COMPOSITION, L'OS INROAD FOURNIT UN ÉCHAFAUDAGE OSTÉOCONDUCTEUR SERVANT DE SUPPORT À LA REPOUSSE OSSEUSE

- **100% SYNTHÉTIQUE**
- AUCUN RISQUE DE TRANSMISSION DE LA MALADIE PAR ALLOGREFFE ET / OU MORBIDITÉ DU SITE DONNEUR AUTOLOGUE
- INROAD NE PRÉSENTE AUCUN PROBLÈME IMMUNOGÈNE ET PEUT ÊTRE FACILEMENT FORMÉ POUR IMITER LA FORME DE L'OS REMPLACÉ
- ABSORBE AINSI EFFICACEMENT LES CELLULES ENDOGÈNES AVEC DES FACTEURS NATURELS FAVORISANT LA RÉPARATION OSSEUSE


STRUCTURES MACRO-MICRO-NANO INTERCONNECTÉES

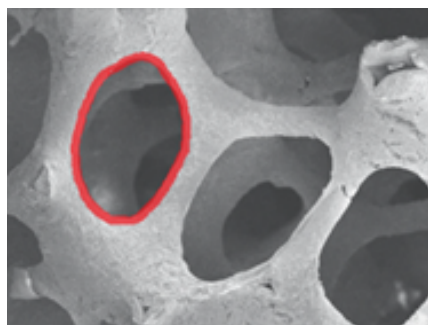

300 - 400 μm

MACRO-PORES


LA MACROPOROSITÉ GUIDE EN PROFONDEUR LES CELLULES ET IMITENT LES PORES DE L'OS TRABÉCULAIRE

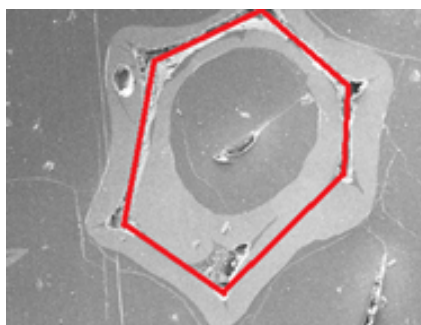

25 - 70 μm

MICRO-PORES

LA MICROPOROSITÉ PERMET LA DIFFUSION ET L'INFILTRATION DES FLUIDES BIOLOGIQUES GRÂCE À L'ACTION CAPILLAIRE

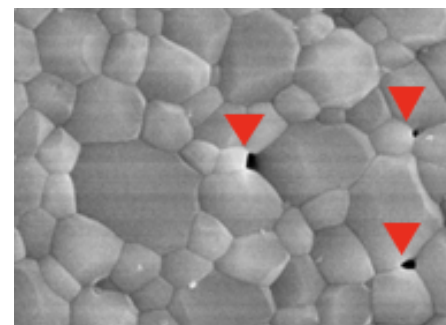


100 - 400 nm


NANO-PORES

LA NANOPOROSITÉ PROCURE DES PROPRIÉTÉS D'ABSORPTION IMPORTANTES ET PERMET AUX CELLULES DE S'ANCRER


OS BOVIN



ALLOGREFFE



INROAD



INSTRUMENTS CHIRURGICAUX



CISEAUX D'OSCHENBEIN

POUR LE REMODELAGE OSSEUX ET LA GESTION DES LAMBEAUX PALATINS.



DÉCOLLEUR BUSER

POUR SÉPARER ET MAINTENIR LES TISSUS GINGIVAUX (PAPILLE ET GENCIVE MARGINALE) APRÈS INCISION.

MANCHE DE BISTOURI



PINCE DE TISSUE D'EDSON



DÉCOLLEUR DE MOLT 9



CURETTE DE MOLT



DÉCOLLEUR PRICHARD



CURETTE CHIRURGICALE



SONDE PARODONTALE



EXCAVATEUR



ECARTEUR MINESOTA



MAILLET



INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

PINCE
PORTE-AIGUILLE



16cm - 14cm

NDH-03

PINCE
HÉMOSTATIQUE



12cm

HMS-02

CISEAU
DE LAGRANDE



11cm

SCI-05

CISEAU
DE DEAN



17cm

SCI-03

COMPAS



8.5cm

GAU-08

ÉCARTEUR MIDDLE DOOF



RTR-MDL

ÉCARTEUR LANGENBECK



RTR-LBDL

CASSETTE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE AVANCÉE

COMPOSÉE DE 19 INSTRUMENTS + 1 CASSETTE



MEH-03



EXP-04



BOC-04



BOC-01



EXC-06



MAL-01



RTR-MS



TIF-03



CST-07



PEE-01



PEE-02



OBC-01



OBC-02



NDH-03



SCI-03



SCI-05



GAU-08



HMS-02



RTR-MDL



RTR-LBDL

INSTRUMENTS D'EXTRACTION

KIT CONVERTISSABLE D'ÉLEVATEURS



ELR-SET



- CONTENU :
- 5 LUXATEURS
 - 3 ROOT PICKERS
 - 7 ÉLEVATEURS
 - 1 MANCHE CONVERTISSABLE

MANCHE
CONVERTISSABLE



ELR-H

ÉLEVATEUR



POUR LES DENTS FRACTURÉES
PENDANT L'EXTRACTION OU POUR
ENLEVER LES RACINES PROFONDES



ÉLEVATEUR C1
MEC-01



POUR LES DENTS FRACTURÉES
PENDANT L'EXTRACTION OU POUR
ENLEVER LES RACINES PROFONDES



ÉLEVATEUR C2
MEC-02



APEX ET PETITES DENTS DANS LA
ZONE POSTÉRIEUR SUPÉRIEUR



ÉLEVATEUR A3
MEA-03



PARTIES POSTÉRIEURES SUPÉRIEURE
ET INFÉRIEURE ET LES RACINES



ÉLEVATEUR A5
MEA-05



ROOT PICKER : POUR LES DENTS
FRACTURÉES PENDANT
L'EXTRACTION



ÉLEVATEUR E1
MEE-01



ROOT PICKER : POUR LES DENTS
FRACTURÉES PENDANT
L'EXTRACTION



ÉLEVATEUR E2
MEE-02



ROOT PICKER : POUR LES DENTS
FRACTURÉES PENDANT
L'EXTRACTION




ÉLEVATEUR E3
MEE-03

SYSTÈME D’ANCRAGE ORTHODONTIQUE


ORACLE

- L’INSERTION DE LA VIS EST TRÈS RAPIDE GRÂCE À UN EXCELLENT AUTO-TARAUDAGE.
- LE RISQUE DE FRACTURE DE LA VIS EST FAIBLE À GRÂCE À UNE EXCELLENTE DURABILITÉ.
- MOINS DE FARDEAU POUR LE PATIENT GRÂCE À LA BASSE-TÊTE AVEC MOINS D’INCONFORT.

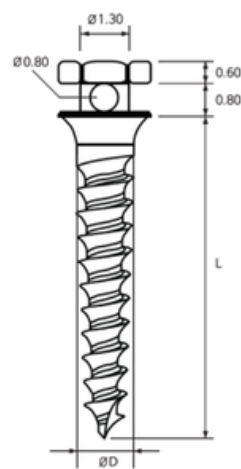


OS FIL OU BANDE ÉLASTIQUE

DIAMÈTRE Ø 1.4		DIAMÈTRE Ø 1.6		DIAMÈTRE Ø 1.8	
RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
OS-HS-14-006	6mm	OS-HS-16-006	6mm	OS-HS-18-006	6mm
OS-HS-14-008	8mm	OS-HS-16-008	8mm	OS-HS-18-008	8mm
OS-HS-14-010	10mm	OS-HS-16-010	10mm	OS-HS-18-010	10mm

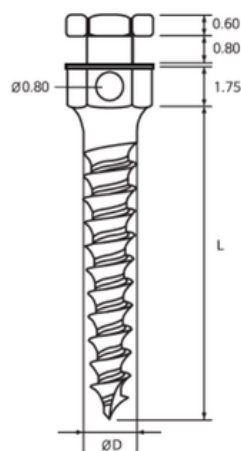


OA FIL ET BANDE ÉLASTIQUE

DIAMÈTRE Ø 1.4		DIAMÈTRE Ø 1.6		DIAMÈTRE Ø 1.8	
RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
OA-HS-14-006	6mm	OA-HS-16-006	6mm	OA-HS-18-006	6mm
OA-HS-14-008	8mm	OA-HS-16-008	8mm	OA-HS-18-008	8mm
OA-HS-14-010	10mm	OA-HS-16-010	10mm	OA-HS-18-010	10mm

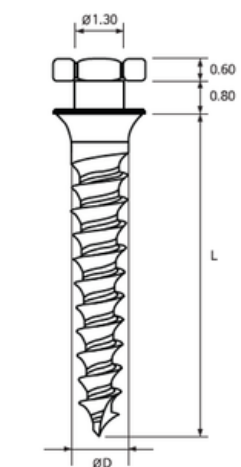

SA BANDE ÉLASTIQUE

DIAMÈTRE Ø 1.4		DIAMÈTRE Ø 1.6		DIAMÈTRE Ø 1.8	
RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
SA-HS-14-006	6mm	SA-HS-16-006	6mm	SA-HS-18-006	6mm
SA-HS-14-008	8mm	SA-HS-16-008	8mm	SA-HS-18-008	8mm
SA-HS-14-010	10mm	SA-HS-16-010	10mm	SA-HS-18-010	10mm

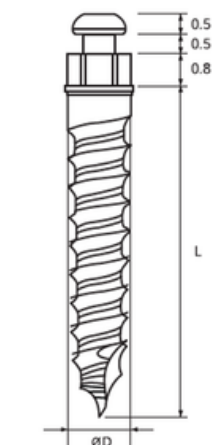


TINY BANDE ÉLASTIQUE

DIAMÈTRE Ø 1.2		DIAMÈTRE Ø 1.4		DIAMÈTRE Ø 1.6	
RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
THS-12-006	6mm	THS-14-006	6mm	THS-16-006	6mm
THS-12-008	8mm	THS-14-008	8mm	THS-16-008	8mm
		THS-14-010	10mm	THS-16010	10mm




OUTILS ORTHODONTIQUES
ORACLE

ADAPTATEURS

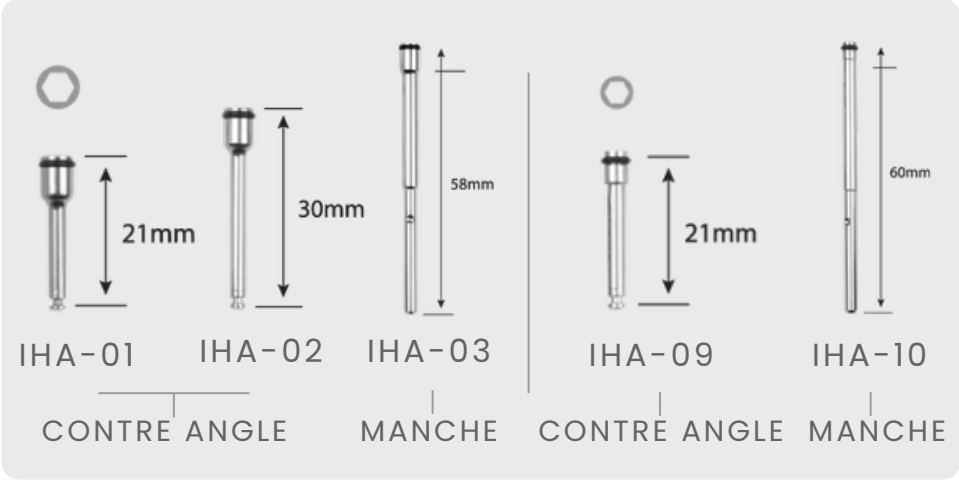

FORETS

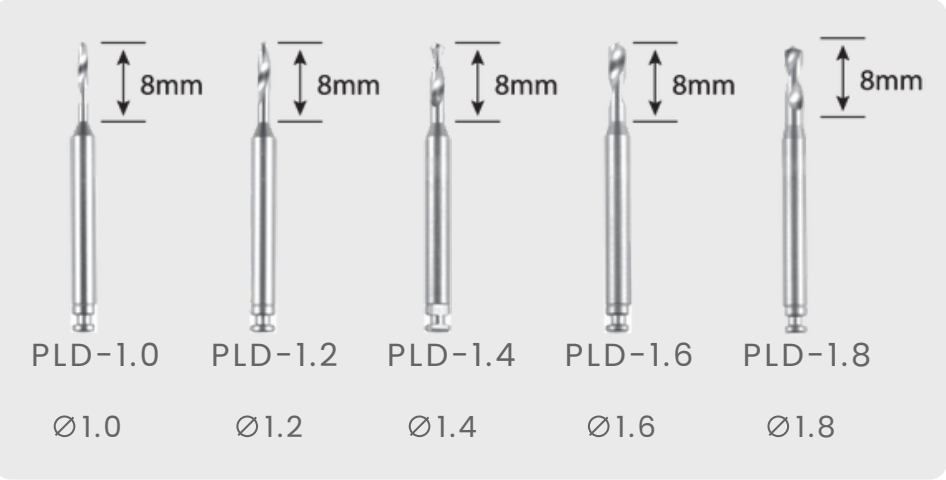

MANCHE 1



MANCHE 2




KIT COMPLET



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
SD-T

PARFAIT À ÊTRE UTILISER AU MAXILLAIRE ET À LA MANDIBULE

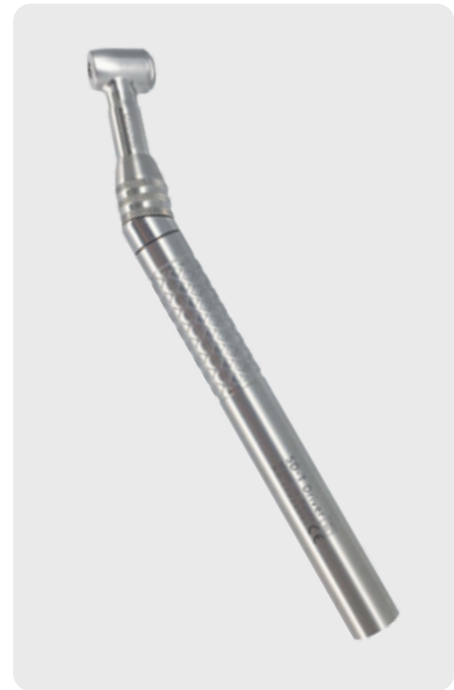

- CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE UNIVERSELLE
- TYPE : CONTRE ANGLE (ACCÈS FACILE EN BOUCHE)
- 3 VALEURS DE TORQUE : 0 - 20 - 35 CM
- LAVABLE DANS LE THERMODÉSINFECTEUR

DIMENSIONS : L118.95 X D : 10.9MM
POIDS : 57G

CONTENU DE L'EMBALLAGE





LOCALISATEUR D'APEX

DR'S FINDER NEO AL-DFA20




- LA PLUS PETITE TAILLE COMPACTE
- DIVERSES MANIÈRES D'ATTACHER (EX. SUPPORT, TABLIER, RÈGLE DENTAIRE INCLUSE, ETC.)




- FONCTION MINUTERIE
- PRÉCISION**

DONNE LA MEILLEURE PRÉCISION EN UTILISANT 3 FRÉQUENCES POUR UNE PRÉCISION EXACTE. L'UTILISATION DU DERNIER SIGNAL IC AMÉLIORE LA PRÉCISION ET LA QUALITÉ DE MESURE.

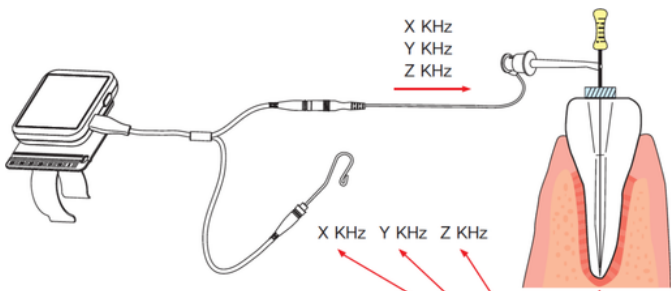


- BATTERIE RECHARGEABLE**
ET L'ALIMENTATION USB DU PC OU ADAPTATEUR DE TÉLÉPHONE PORTABLE (MICRO 5 PIN TYPE)
- CALIBRATION**
PEUT VÉRIFIER QUE L'APPAREIL EST PRÉCIS SIMPLEMENT AVEC UN JIG DE CALIBRATION ET CALIBRER L'APPAREIL PAR VOUS-MÊME.

- SÉLECTION DE LA LONGUEUR DE TRAVAIL**

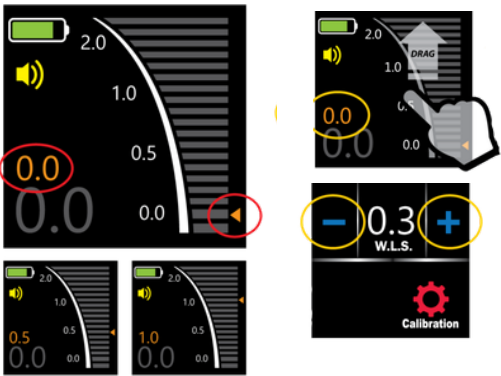

- ACCESSOIRES**

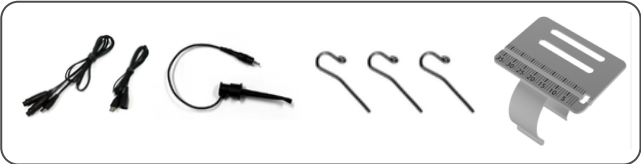


LOCALISATEUR D'APEX

DR'S FINDER AL-DF10



- FORMAT COMPACT**
FACILE À UTILISER ET À DÉPLACER
- BATTERIE RECHARGEABLE**
L'UTILISATEUR N'A PAS BESOIN DE CHANGER LA BATTERIE.
- SÉLECTION DE LA LONGUEUR DE TRAVAIL**

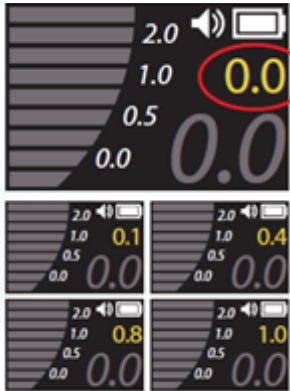


LES MÉDECINS PEUVENT SÉLECTIONNER LEUR PROPRE LONGUEUR DE TRAVAIL POUR UNE UTILISATION PRATIQUE



RÉGLEZ LE EN APPUYANT BRIÈVEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE.

- ECRAN OLED COULEUR**

- ACCESSOIRES**

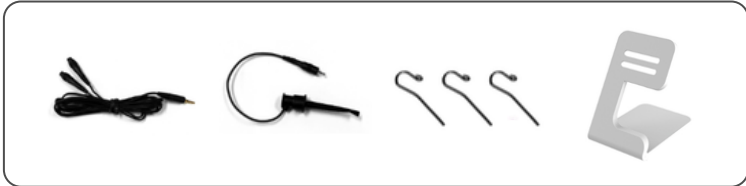

- DIMENSIONS** : 55 x 85 x 21 mm
- POIDS** : 65 g (carte incluse)
- CORDON DE SONDE** : env. 130 cm
- CROCHET DE FICHIER** : 65 mm
- CROCHET À LÈVRES** : 65 mm



SYSTÈME D'OBTURATION

ENDO@PEX

Friendo

STYLO À CONDENSATION VERTICAL


- Matériau d'obturation canalaire adoucissant.
- Épandage vertical du matériau d'obturation canalaire.
- Découpe des points de gutta-percha des matériaux d'obturation du canal radiculaire.
- Découpe des poignées d'obturateurs en plastique.



Gutta Easy

PISTOLET D'OBTURATION THERMOPLASTIQUE

- Obturation thermoplastique (remplissage) de matériaux d'obturation canalaire.

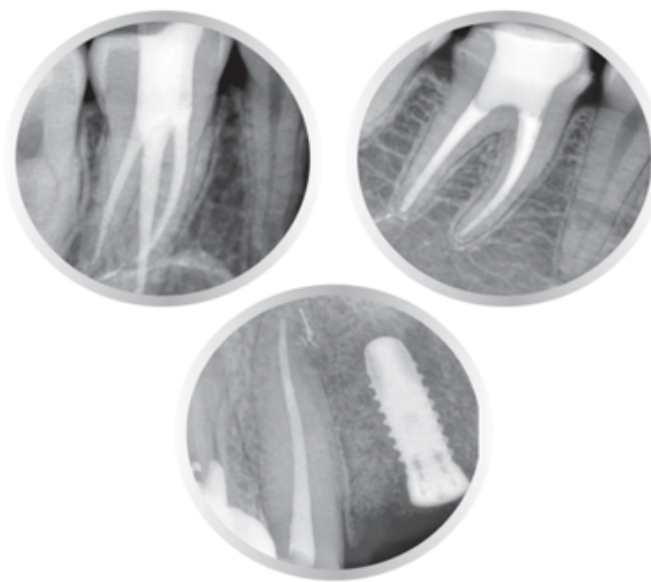

SYSTÈME D'OBTURATION SANS FIL 2-IN-1

VITESSE DE CHAUFFE : 3 TEMPÉRATURES

POINTE PIVOTANTE À 360 : POUR UN MEILLEUR ACCÈS AUX ZONES DIFFICILES DU CANAL.

EQUILIBRE DE POIDS : FRIENDO NE PÈSE QUE 68 G ET EST TOUT SIMPLEMENT LE PLUS LÉGER DE SON TYPE.

PROTECTION THERMIQUE : PRÉVIENT LES BRÛLURES ACCIDENTELLES CAUSÉES PAR UNE POINTE CHAUDE OU DE LA GUTTA PERCHA

DURÉE DE VIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE : DURE ENVIRON 20% PLUS LONGTEMPS QUE TOUTE AUTRE MARQUE DE BATTERIE

COMPOSANTS



Pièce à main Friendo



Pièce à main Gutta Easy



base de chargeur double



accessoire de pièce à main



Protecteur de pièce à main en Silicone



Pointes de Stylo : 5 Tailles



boîtier de pièce à main Friendo



Anneau téflon



Fouloir de Pistolet (23G/25G)



Protecteur Thermique



brosse de nettoyage téflon



Granules de Gutta-percha



Piston (Plunger)



Outil Multi- Fonction



Adaptation




Cable d'alimentation

MOTEUR D'ENDO

KRAFIT CLASS A LED




CONVIENT À TOUTES LES PROCÉDURES ENDODONTIQUES AVEC LUMIÈRE LED

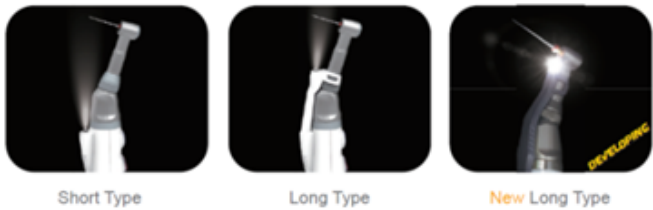

- ÉCRAN LCD LARGE
- ARRÊT AUTOMATIQUE AU SENS INVERSE
- SYSTÈME DE RÉCIPROCITÉ
- 9 PROGRAMMES DE MÉMOIRE
- BATTERIE LI-ION : 90MIN D'UTILISATION

DIMENSIONS : 112 X D174 X H77
POIDS : 310G
VITESSE : 150 - 600 RPM

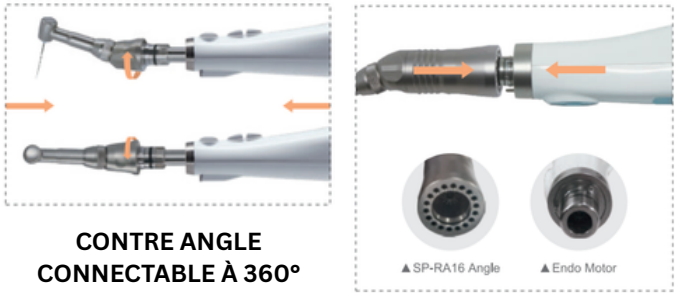

CONTENU DE L'EMBALLAGE



RÉSINE AUTO-POLYMÉRISABLE

CHAIRSIDE



RÉSINE COMPOSITE AUTO-POLYMÉRISABLE POUR LES ATTACHEMENTS PROTHÉTIQUES (COMME LES SYSTÈMES LOCATOR ATTACHMENT SYSTEM) AUX PROTHÈSES AMOVIBLES

- CONTIENT :
- 2 SERINGUES DE 8G
 - TUBES

STRIP ABRASIF

POLISHING STRIP FINE



STRIP ABRASIF DE POLISSAGE POUR COMPOSITE

TAILLE : 30 MICRONS

PAPIERS À ARTICULER

SHIMSTOCK



MATÉRIAU UTILISÉ POUR REPÉRER DES POINTS DU 1ER CONTACT ET POUR UN CONTRÔLE FINAL PRÉCIS.

TAILLE : 8MM X 10M

PAPIER D'OCCLUSION

BAUSCH ARTI-CHECK



MATÉRIAU UTILISÉ POUR ENREGISTRER LES POINTS DE CONTACT DE L'OCCLUSION.

TAILLE : 40 MICRONS

- | | | |
|-------|---|------------|
| BK-08 | : | BLUE/ROUGE |
| BK-09 | : | BLUE |
| BK-10 | : | ROUGE |

saeyang



GoodDrs

MCTBIO



MedPark
Your Reliable Partner

CYBERMED



OSSTEM[®]
IMPLANT

 06 69 40 77 14
 www.dentalgatewayintl.com
 Casablanca, Maroc

 Dental
Gateway
International